



Test di competenza del laboratorio nell'UE

Tasso di errore dei test nei laboratori partecipanti

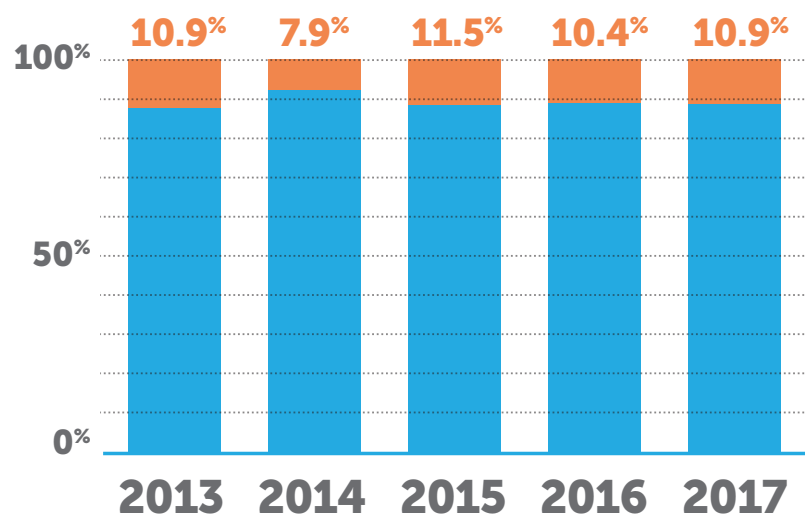

Chiave: ■ Riuscito ■ Fallito

Tasso di errore per parametro (più frequente)

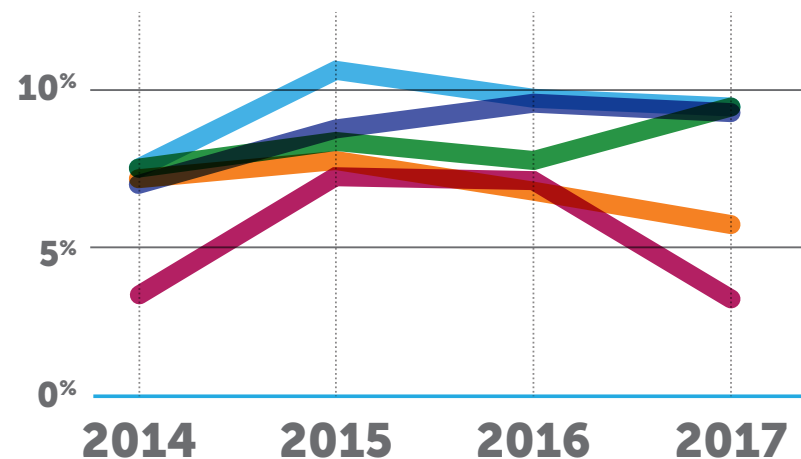

Chiave: ■ Azoto totale ■ Fosforo totale
■ Nitrato ■ Ammoniaca ■ COD

Source, University of Stuttgart, <http://www.iswa.uni-stuttgart.de/ch/aqs/>



Be Right™